

# Armatura zanurzeniowa do pomiaru pH-REDOX 9346



- Wspornik chroniący elektrodę
- Prosta kalibracja
- Dla 2 lub 3 elektrod do przyłącza Pg 13,5
- Wykonanie PVC lub PPH
- Mocowanie regulowanym kołnierzem lub zaciskiem
- Wyjście kablowe dławikiem
- Łatwy montaż i obsługa

## ZASTOSOWANIE

Pomiar pH lub potencjału redox w basenach, kanałach lub zbiornikach. Armatura z możliwością kompensacji temperatury jest zaprojektowana do ochrony elektrod pomiarowych przed uderzeniami mechanicznymi i gwarantuje ochronę przeciw zawilgoceniu połączeń z elektrodą.

## POWIĄZANE ELEKTRODY

Jedynie elektrody szczelne dzięki Pg 13,5 mogą być użyte do armatury. Pasujące elektrody do wyboru z naszej gamy elektrod pH i Redox (Dok. 150-01).

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

|                                                                   |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Głębokość zanurzenia                                              | 1 000 mm (od 200 do 3 000 mm na zapytanie)                                |
| Wykonanie standardowe                                             | PVC lub PPH                                                               |
| Mocowanie                                                         | Kołnierz PE 9358 z elementem ślizgowym do regulacji lub zaciskiem PE Ø 75 |
| Temperatura maks.                                                 | + 55 °C (PVC)<br>+ 100 °C (PPH)                                           |
| Maksymalna dopuszczalna temperatura zależy od używanych elektrod. |                                                                           |

## KODY I REFERENCJE

| Kod     | Referencja | Opis                                 |
|---------|------------|--------------------------------------|
| 135 520 | 9346/2 PVC | Armatura PVC - 2 przyłącza Pg 13,5   |
| 135 530 | 9346/3 PVC | Armatura PVC - 3 przyłącza Pg 13,5   |
| 135 620 | 9346/2 PPH | Armatura PPH - 2 przyłącza Pg 13,5   |
| 135 630 | 9346/3 PPH | Armatura PPH - 3 przyłącza Pg 13,5   |
| 135 112 | 9358 PE    | Regulowany kołnierz PE do 9346 DN 65 |
| P41 576 | Ø 75 PE    | Zacisk z uchwytem PVC-C              |

## KOMPENSATOR TEMPERATURY

Kompensatory temperatury są do wyboru z naszej gamy 9090(DOK. 150-02).

# BAMO POLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL [www.bamopolska.pl](http://www.bamopolska.pl)  
E-mail [info@bamopolska.pl](mailto:info@bamopolska.pl)


Armatura zanurzeniowa do  
pomiaru pH-REDOX  
**9346**

13-12-2017

D-135.01-PL-AB

pH

135-01 /1

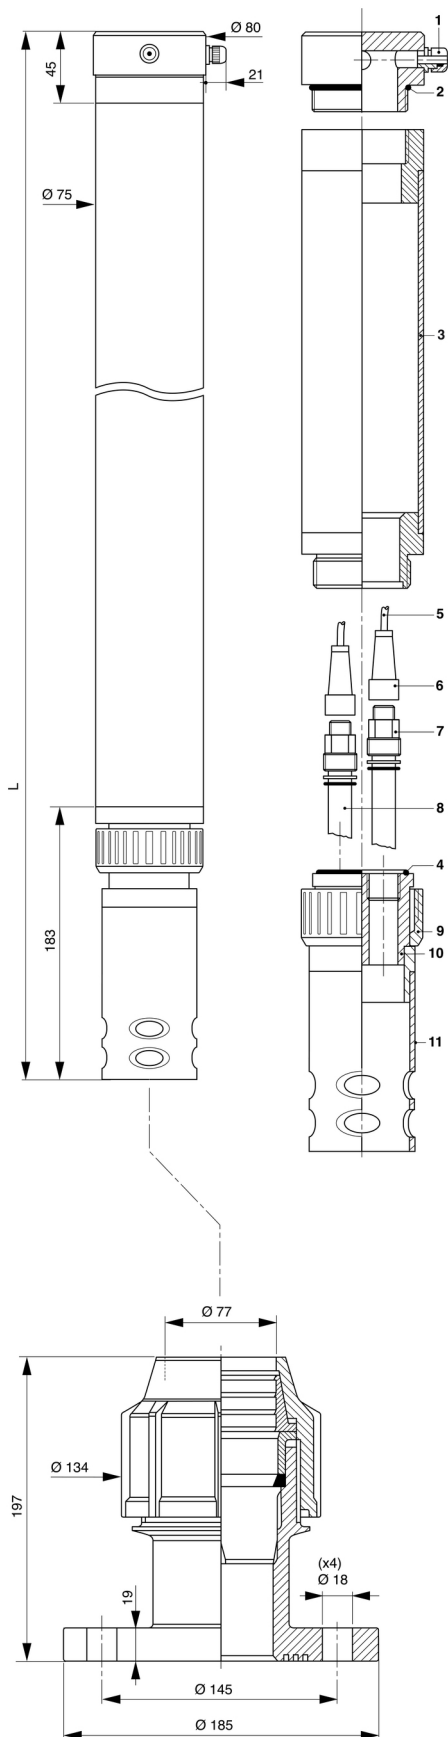

## MONTAŻ ELEKTRODY

- Wprowadzić kabel pomiarowy pH 9060 (5) dławikiem obudowy przyłączeniowej (1).
- Przepuścić kabel na długość równej długości armatury + 20 cm.
- Przyspawać łącznik 9054 (6) do kabla (patrz DTR pH 160).
- Sprawdzić obecność uszczelki (2) na wsporniku
- Przykręcić wspornik (1) na rurze przedłużającej (3).
- Upewnić się, że łącznik wychodzi z dołu rury.
- Zamontować elektrodę pomiarową pH lub redox (7 i 8) na wsporniku (10).
- Ułożyć uszczelkę (4) wokół górnej części elektrody.
- Przykręcić łącznik do czołówki elektrody
- Delikatnie pociągnąć kabel pomiarowy, aby przybliżyć wspornik elektrody do rury przedłużającej.
- Kabel wewnątrz rury nie może być naprężony.
- Dokręcić nakrętkę (9) trzymając wspornik elektrody
- Dokręcać ręcznie, niezbyt mocno!
- Unikać rotacji wspornika elektrody podczas tej fazy.
- Dokręcić ręcznie osłonę ochronną elektrody (11).
- Musi ona być łatwo demontowana w przyszłości.
- Zacisnąć dławik w górnej części.

## DEMONTAŻ ELEKTRODY

Postępować w sposób odwrotny, zwracając uwagę, by nie zgubić uszczelki (4).

## KALIBRACJA

- W celu umieszczenia pojemników z roztworami kalibrującymi, należy się odnieść do DTR pH i rH metru
- Umyć elektrodę czystą wodą.
- Odkręcić osłonę ochronną elektrody.
- Wprowadzić wspornik elektrody do pojemnika roztworu kalibrującego.
- Po fazie kalibracji, zamontować osłonę ochronną, delikatnie ją dokręcając.

# BAMO POLSKA

Al. Krakowska 271 · 02-133 WARSZAWA

Nr tel. +48 666 311 122 URL [www.bamopolska.pl](http://www.bamopolska.pl)  
E-mail [info@bamopolska.pl](mailto:info@bamopolska.pl)

Armatura zanurzeniowa do  
pomiaru pH-REDOX  
**9346**

13-12-2017

D-135.01-PL-AB

pH

135-01 /2